


ВЕЧНИК 31,5x35 (1) D-4

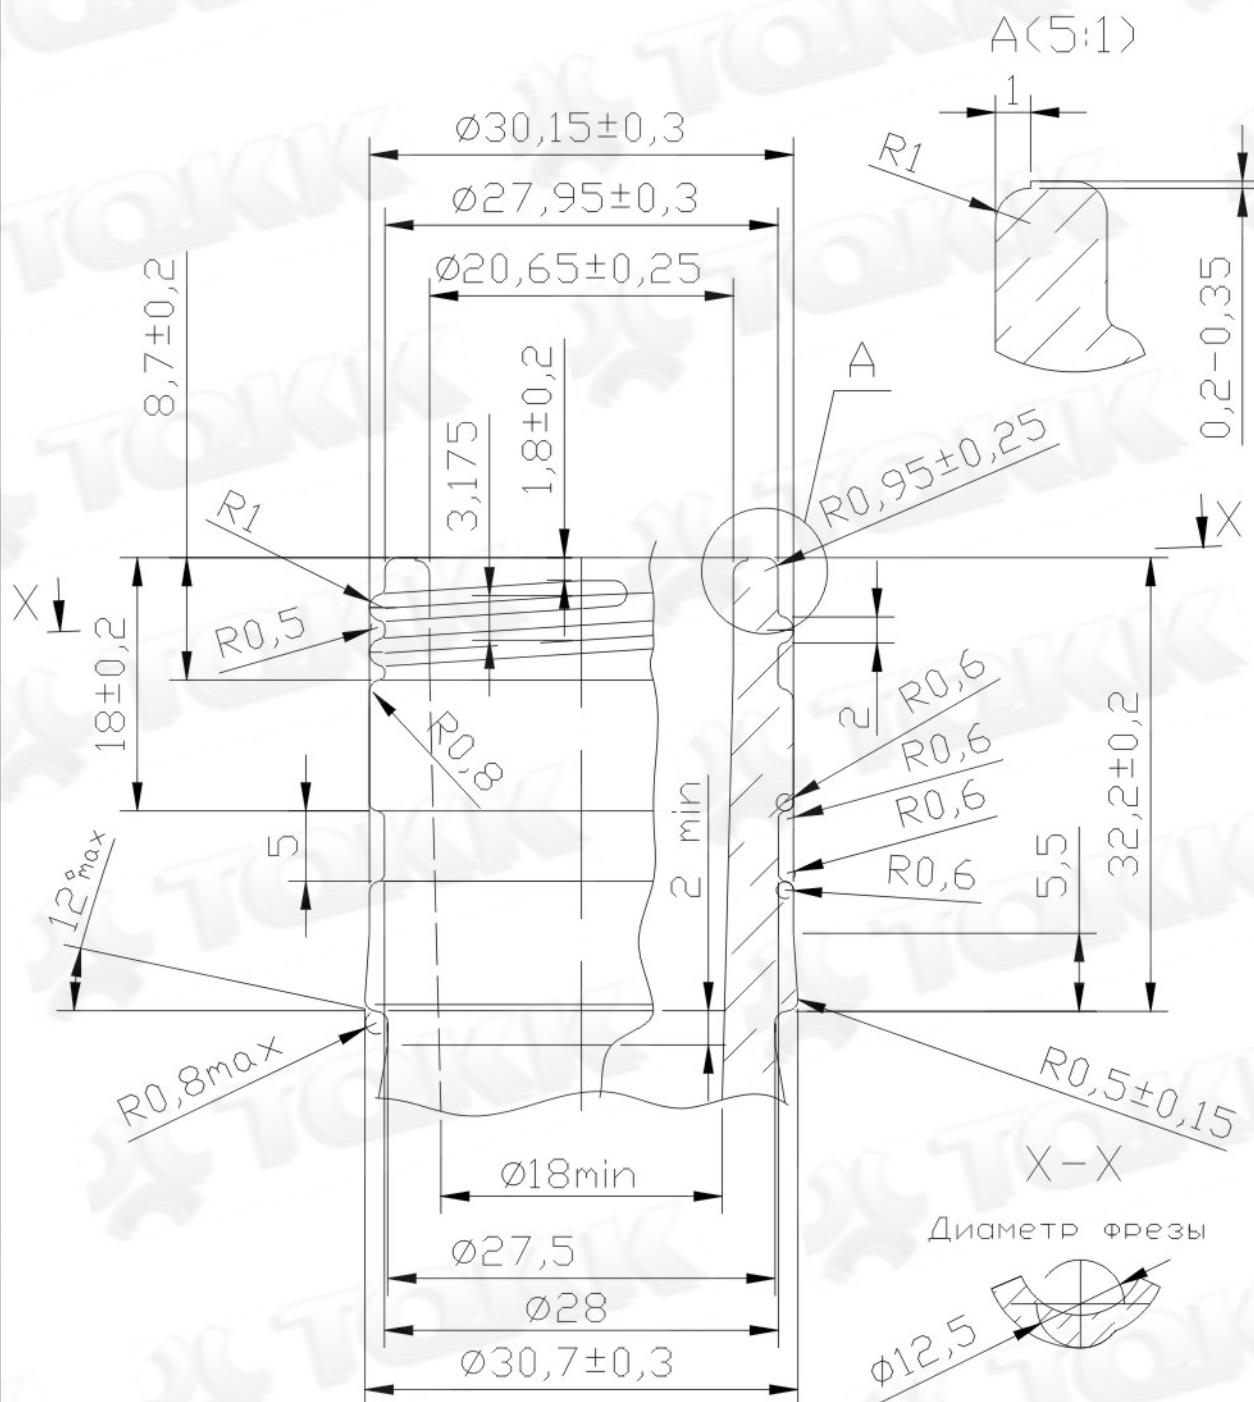

1. Неуказанные предельные отклонения размеров:
линейных $\pm 0,2$; угловых $\pm 1^\circ$.
2. Размер $\varnothing 21,25 \pm 0,25$ для фиксации дозатора обеспечить на расстоянии 14 мм от верхнего среза венчика.