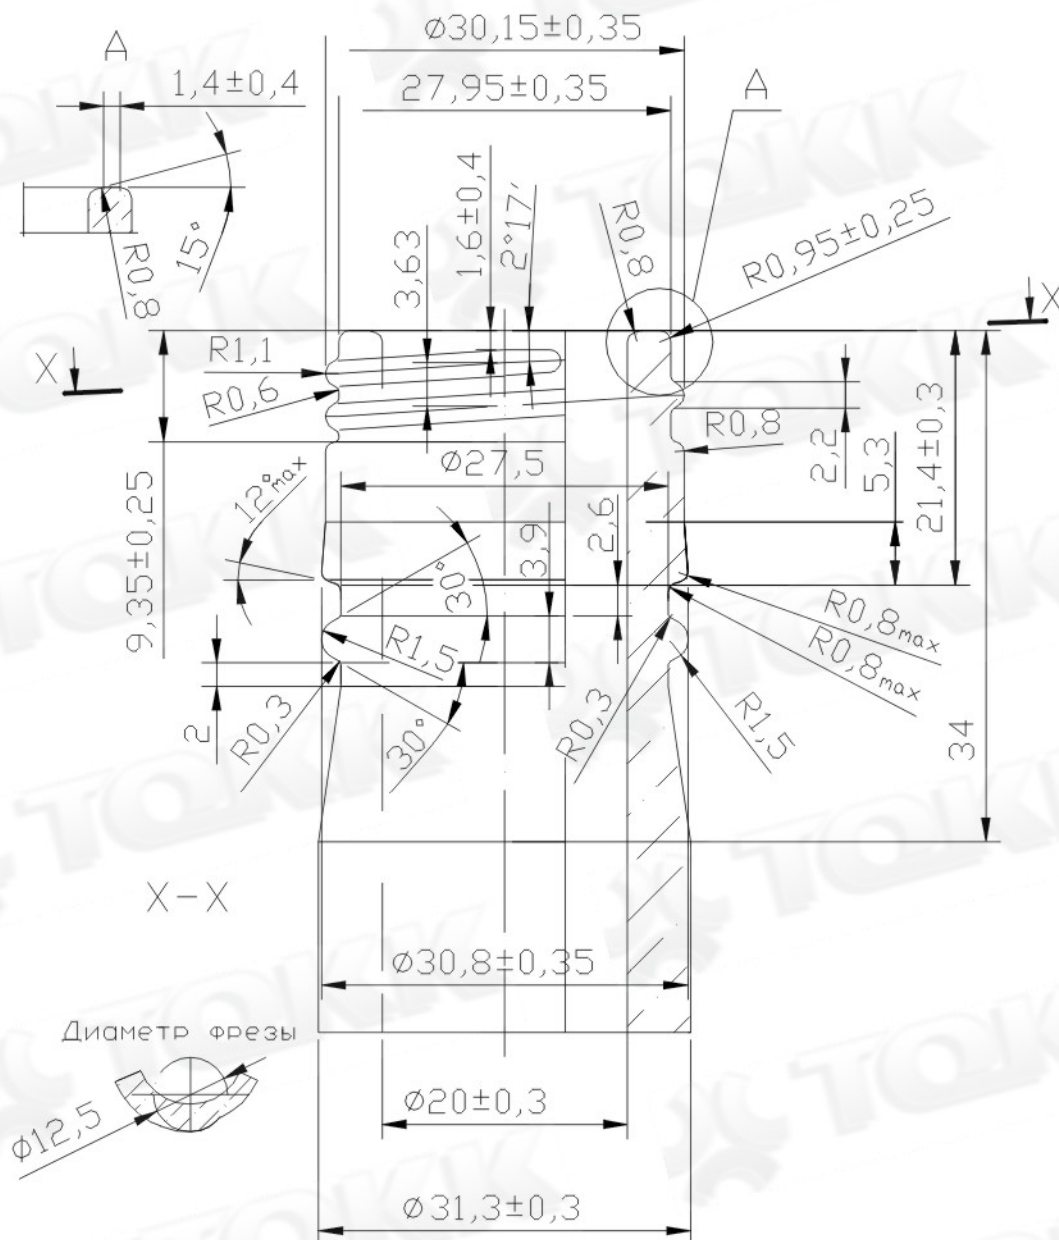


ВЕНЧИК 31,5x35 D-2

1. Неуказанные предельные отклонения размеров:
 линейных- $\pm 0,2$; угловых- $\pm 1^\circ$

2.* Размеры для справок.

3. Размер $\phi 20 \pm 0,3$ для фиксации дозатора обеспечить
 на глубине 14 мм от верхнего среза венчика