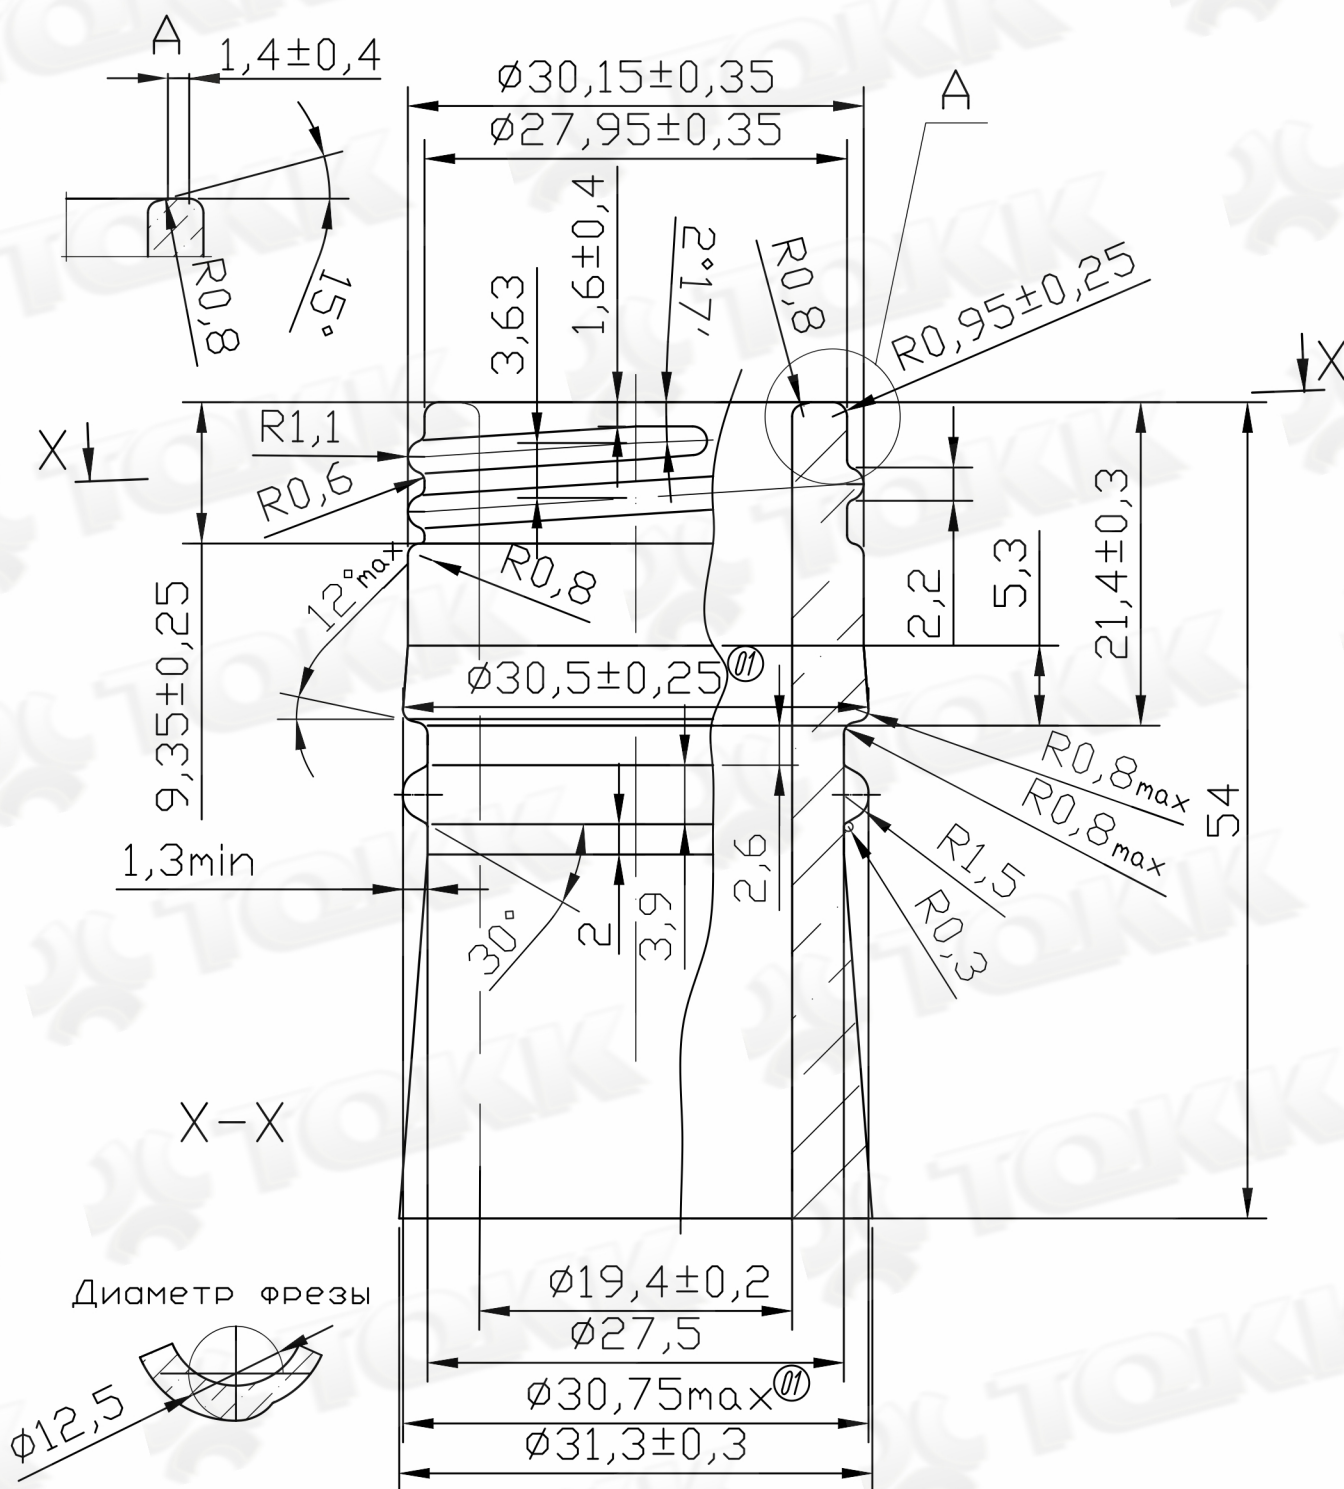


ВЕНЧИК 31,5x55 D-1

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: линейных $-\pm 0,2$; угловых $-\pm 1^\circ$.
- 2.* Размер для справок.
3. Размер $\phi 19,4 \pm 0,2$ для фиксации дозатора обеспечить на расстоянии 14 мм от верхнего среза венчика.